

HEALTH CONNECT

Dado que el dispositivo Fitbit ya registra los pasos, la función correspondiente en la aplicación "Health Connect" debe permanecer desactivada. De lo contrario, se produciría una incongruencia entre los pasos registrados por Fitbit (que se contabilizan cuando se lleva la pulsera puesta) y los registrados por Health Connect (que solo se contabilizan cuando se lleva el teléfono encima).

Por esta razón, la función en la aplicación debe mantenerse desactivada.

A continuación, una captura de pantalla que muestra que la función **NO está ACTIVADA** (Para verlo, debe ir a la sección *Perfil*, lo encontrará debajo de *Ajustes*).

16:15



Exporte sus datos

Cerrar sesión

Historia clínica



Ajustes



Recordatorio

Mis dispositivos

Health Connect




Intercambio de datos

Informaciones




En caso de que, por error, la función se active, le rogamos que la desactive.

Cuando está activado, se muestra de la siguiente manera:

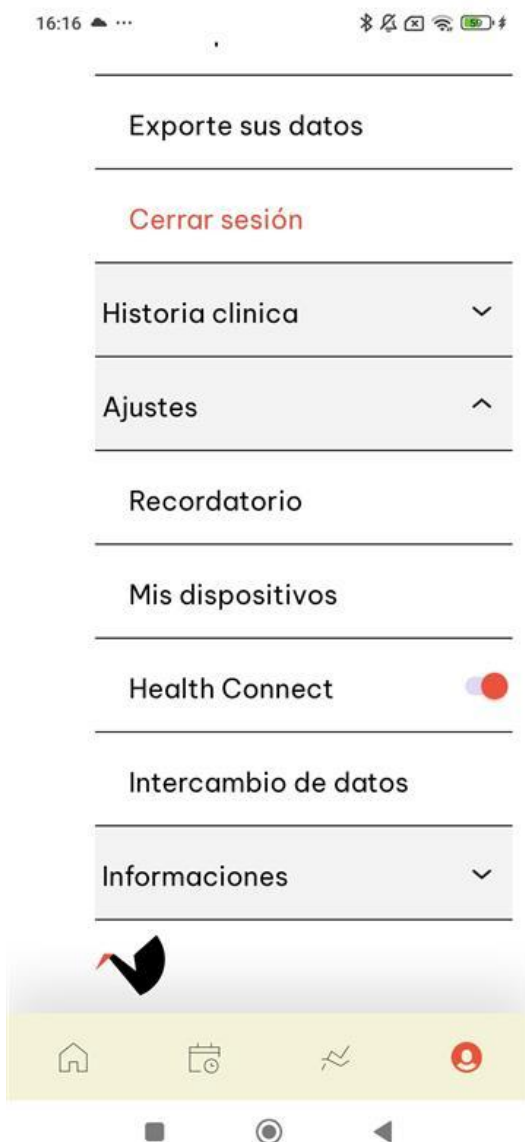

Para desactivarla, es necesario pulsar el interruptor junto a *Health Connect*. Aparecerá un mensaje que pregunta: “¿Está seguro de que desea desactivar la aplicación?”.

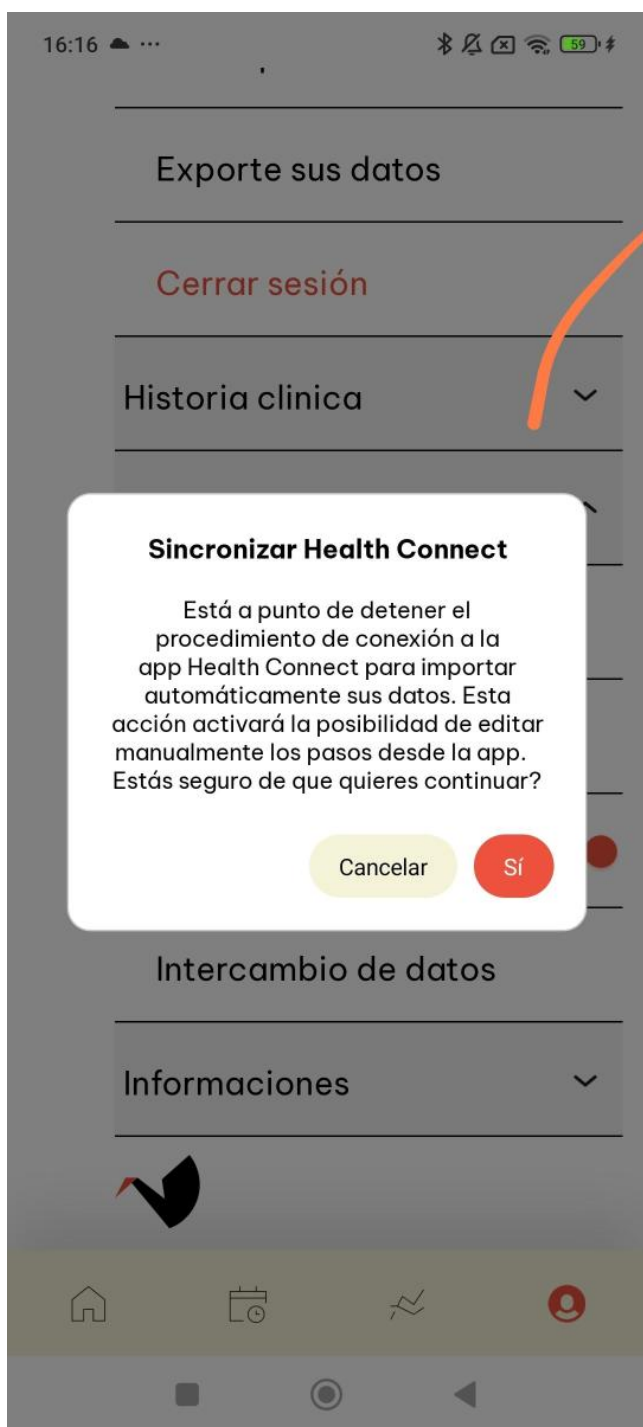

Debe seleccionar “Sí” y podrá ver que el interruptor ya no estará activado, sino que se apagará (se volverá gris).