


HEALTH CONNECT

Eftersom Fitbit-enheten redan registrerar steg måste motsvarande funktion i appen "Health Connect" förbli avstängd. Annars kan det uppstå en skillnad mellan stegen som registreras av Fitbit (när armbandet är på) och de som registreras av Health Connect (som endast registreras när man har med sig telefonen).


Av denna anledning måste funktionen i appen hållas avstängd.

Nedan visas en skärmdump som bekräftar att funktionen INTE ÄR AKTIVERAD (för att se detta, gå till Profil-sektionen; du hittar det under Inställningar).

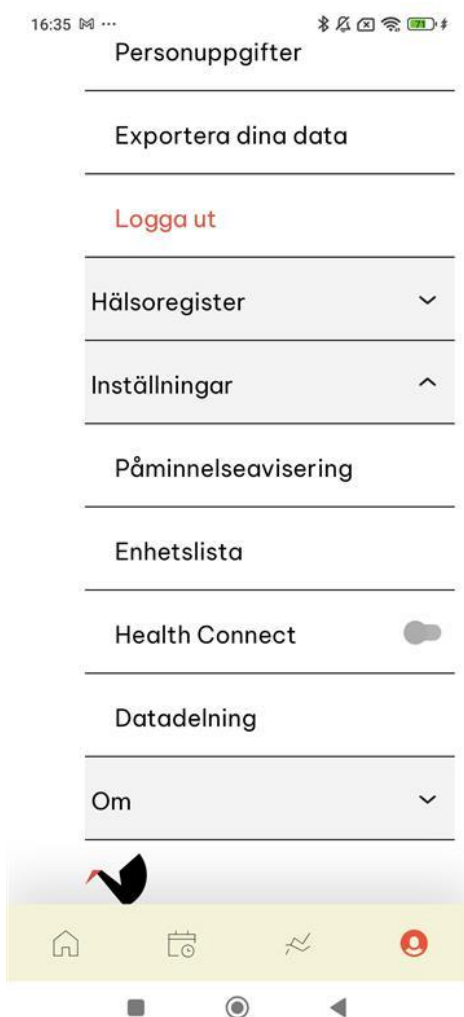

Om funktionen av misstag skulle aktiveras, ber vi dig vänligen att stänga av den.

När den är aktiverad visas den på följande sätt:

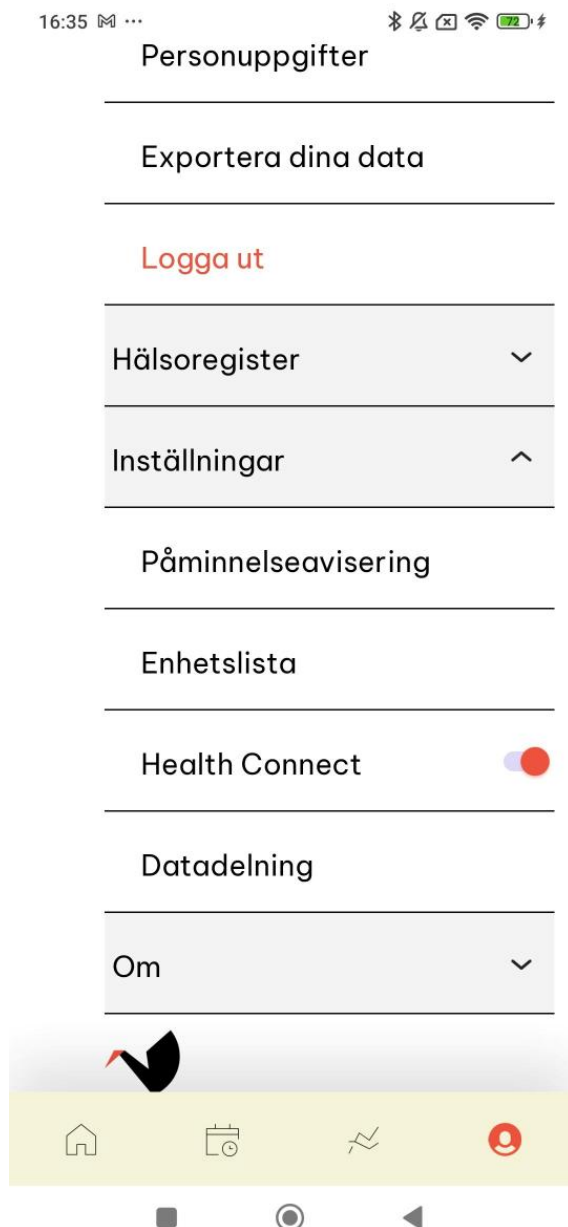

För att stänga av den måste du trycka på reglaget bredvid Health Connect. Ett meddelande kommer att visas som frågar: "Är du säker på att du vill inaktivera appen?"



Du måste välja "Ja", och du kommer att se att reglaget inte längre är aktiverat utan avstängt (det blir grått).